


# Postreanimationsphase

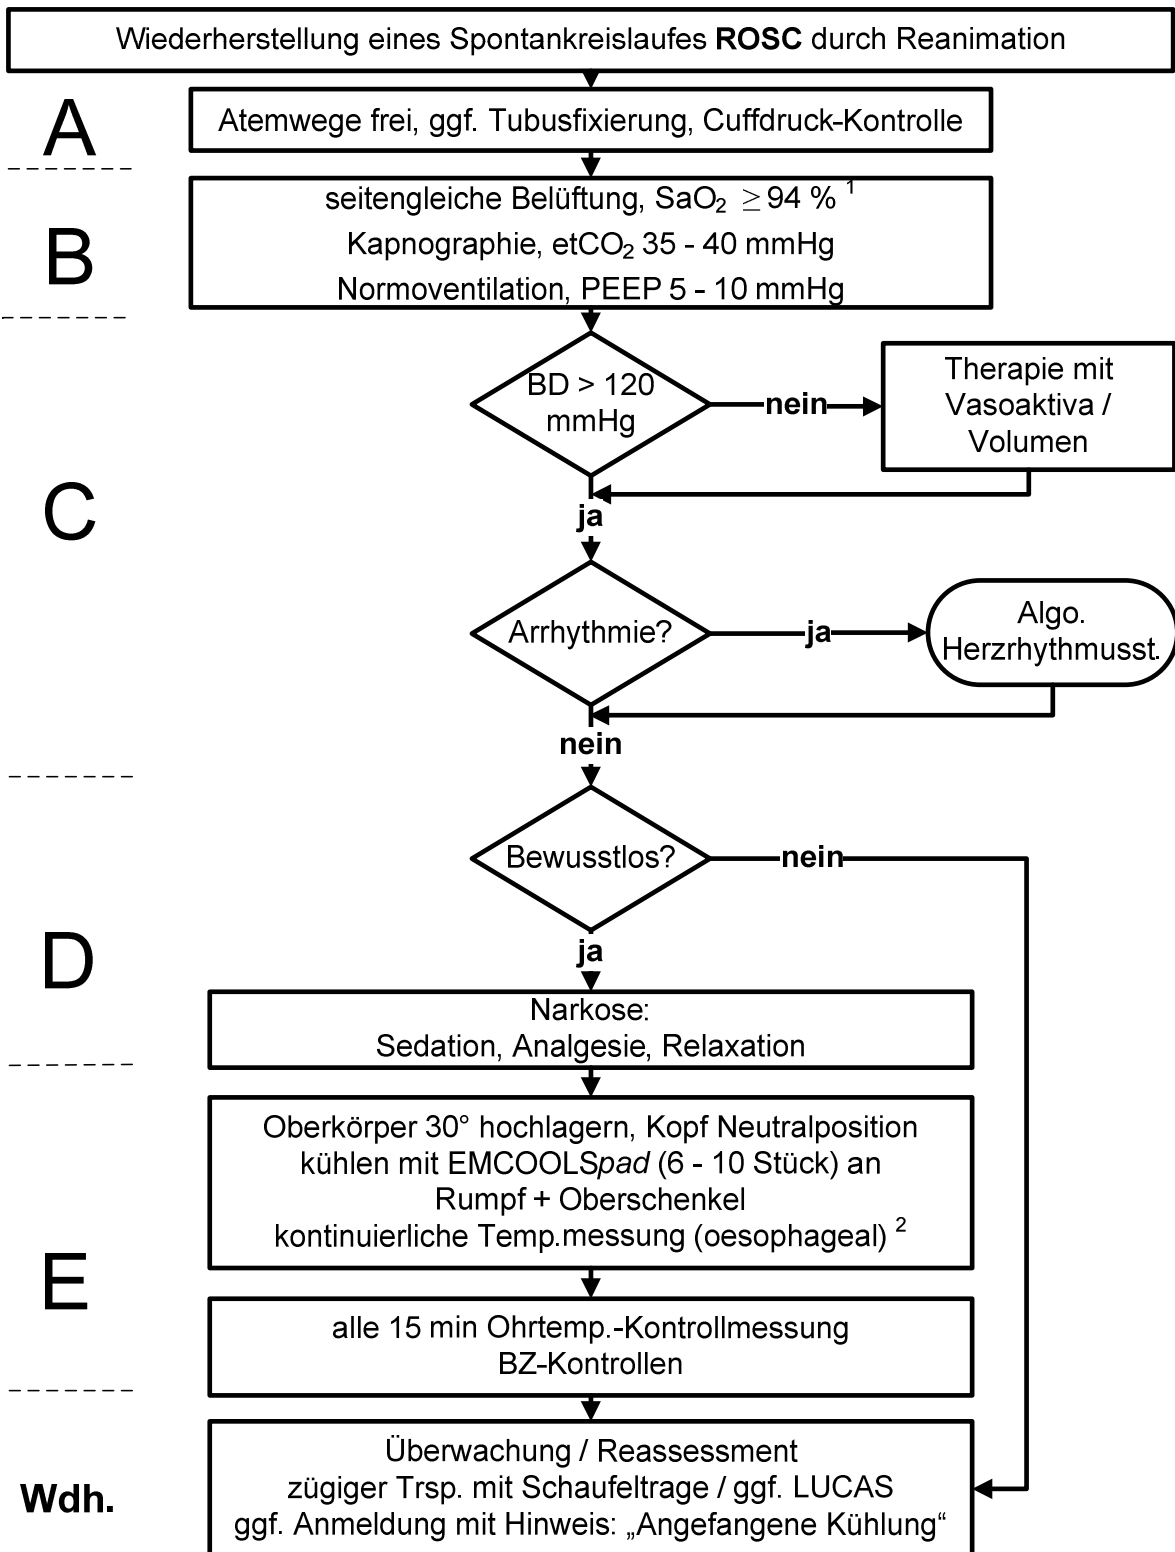

- <sup>1</sup> FiO<sub>2</sub> anpassen
- <sup>2</sup> Bei 34°C Körpertemperatur alle EMCOOLSpad entfernen, Zieltemperatur 32 - 34 °C.
- Vasoaktiva bereit halten, frühzeitig Kreislauftherapie
- Reanimationsbereit sein, Sauerstoffvorrat beachten